取扱説明書

昇降式
洗面ユニット
SAD−220

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
  正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- 「取扱説明書」は
  ・1部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
  ・1部を保存用として、大切に保管してください。

SAKAImed

06-034⑥M1

もくじ

安全上のご注意 …… 3

各部の名称 …… 5

ご使用になる前に …… 6
- 電源 …… 6
- 周囲の点検 …… 6

操作方法 …… 7
- 洗面台の昇降 …… 7
- シングルレバー混合水栓 …… 7

お手入れの仕方 …… 8

このようなときには …… 8

機器の保守・点検について …… 9

保証とアフターサービス …… 10

仕 様 …… 11

用途

本装置は、ADL トレーニングにおける洗面動作トレーニングのためのもので、種々の条件を再現するために、洗面器の高さを調節できるようにした上下調節式洗面ユニットです。

特長

- **省スペースのコンパクトタイプ洗面ユニット。**
  上部には小物を置くことができるトレイ付きです。
  壁面取付式で、既存の洗面ユニットと簡単に付け替えができます。
- **操作性の向上を図りました。**
  昇降スイッチは使用者も操作しやすいリモコン式です。
  高さ調節機構は電動式のため、スムーズな昇降、停止ができます。

安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、
各注意事項をよくお読みのうえ、
必ずお守りください。

注意事項を次のように区分しています。

⚠危険 ・・・ 取り扱いを誤ると、
死亡または重傷を負うことに至るもの

⚠警告 ・・・ 取り扱いを誤ると、
死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの

⚠注意 ・・・ 取り扱いを誤ると、
傷害または物的損害の発生が想定されるもの

絵表示の意味

禁　止：してはいけない「禁止」内容のものです。

強　制：必ず実行していただく「指示」内容のものです。

電源・その他

⚠警告

電源コード及び、プラグの改造等は、絶対に行わない
感電の恐れがあります。

ぬれた手でプラグの抜き差しはしない
感電の恐れがあります。

⚠注意

電源電圧は AC100V±5%の範囲内で使用する
範囲外の場合には機器の故障及び誤動作の原因になります。

サービスマン以外は、給湯水の接続を行わない
正しく接続しないと水もれ等の故障や事故の原因になります。

給湯水栓

⚠注意

湯温に注意
止水後、再び吐水するときは、若干温度が変化することがありますのでしばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

レバーハンドルはゆっくり動かす
急に操作すると音が出たり、吐出温度が急に変わります。

熱湯を吐出させたときの給湯部に注意
高温になっていますので、やけどに十分注意してください。熱湯の吐出後は、安全のためしばらく水を流して冷やしてください。

洗面台の昇降

⚠ 注意

使用者が洗面器を使用中には、昇降操作しない
使用者がけがをする恐れがあります。

洗面器には、30kg 以上の力を掛けない
故障の原因や事故につながる恐れがあります。

リモコンの上昇と下降スイッチは、同時に押さない
故障及び誤作動の原因となります。

昇降させる前に、周囲を確認
周囲や洗面器の下に障害物があると、挟み込む恐れがあります。

リモコンスイッチは、水につけない
水没すると故障の原因となります。

使用上の注意

⚠ 注意

電動アクチュエーターに水をかけない
簡易防水ですが、故障の恐れがあります。

トレイには 1 kg以上の物を置かない
破損する恐れがあります。

クレンザー等の研磨剤や酸性洗剤などは使用しない
みがき粉等の粒子を含んだ洗剤やナイロンタワシ，ブラシ等は塗装等の表面を傷つけます。

機器の改造はしない
故障の原因や事故につながる恐れがあります。

使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜く
誤動作などの事故を防止します。

清掃時にシンナー，ベンジンなどで拭かない
塗装及び製品表面を侵す恐れがあるので使用しないでください。

医師や指導者の指示に従ってトレーニングを行う
指示以外のトレーニングはけがや事故の恐れがあります。

各部の名称

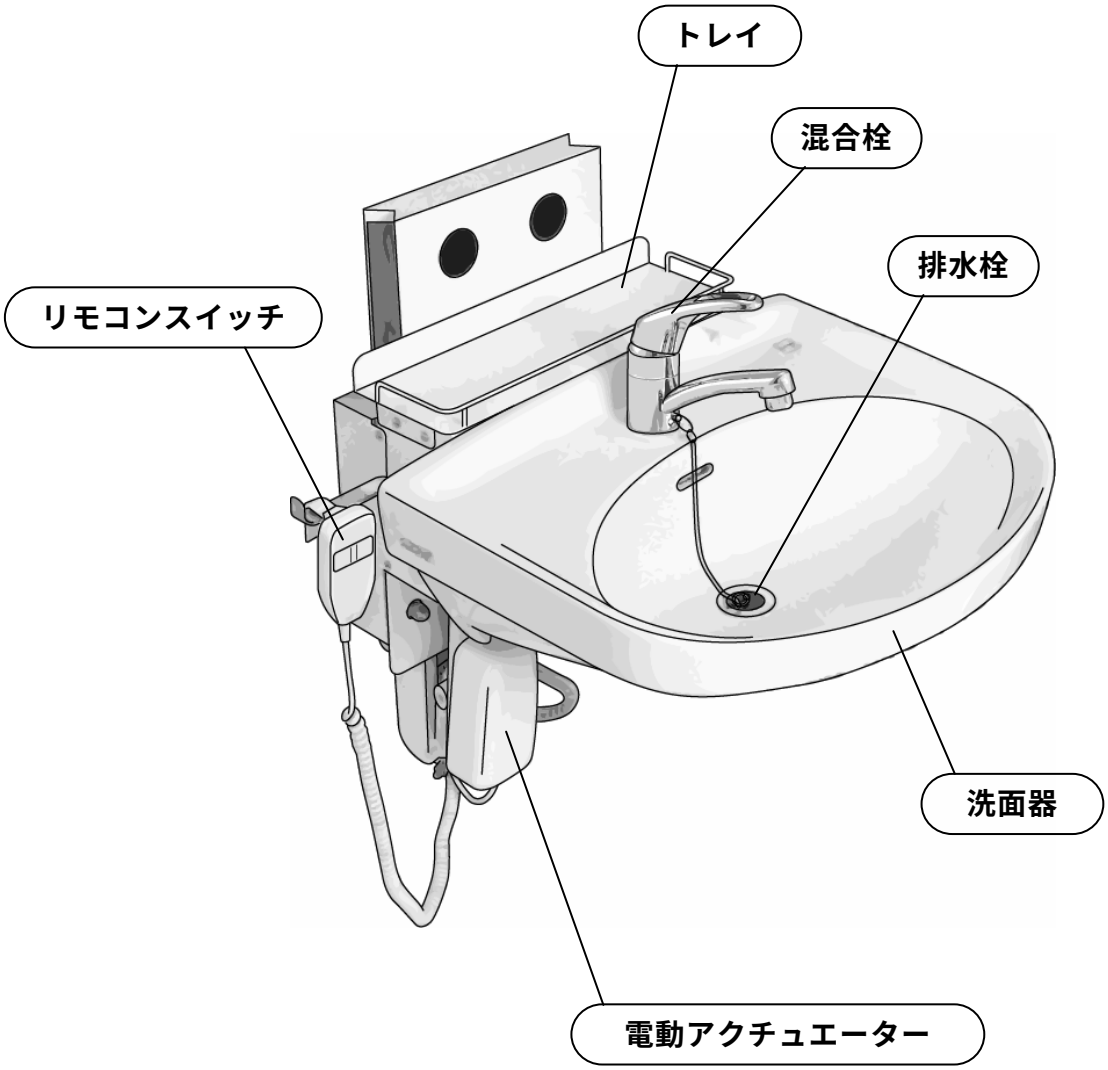

◆ 構成

•昇降式洗面ユニット(SAD-220)　　・・・1台

ご使用になる前に

ご使用前に本製品についてP.9の**始業点検項目**にもとづき、始業点検を実施してください。またこれ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになられていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、電源を切って最寄りの営業所にご連絡ください。

破損、異常を感じたままのご使用は、危険ですから絶対におやめください。

電源

- この装置はコンセントに接続して使います。使用前に電源のヒューズやブレーカーが切れていないか点検してください。
- 電源には、必ず漏電遮断器を接続してください。
- プラグをコンセントに差し込みます。

⚠ 警告 ・電源コード及び、プラグの改造等は、絶対に行わない
・ぬれた手でプラグの抜き差しはしない

周囲の点検

周囲に障害物がないか確認してください。また、洗面器の下には物を置かないでください。

操作方法

洗面台の昇降

リモコンスイッチで洗面器が昇降します。
スイッチを押すと動き、離すと停止します。
上限及び下限では自動的に停止します。
リモコンスイッチは簡易防水になっています。

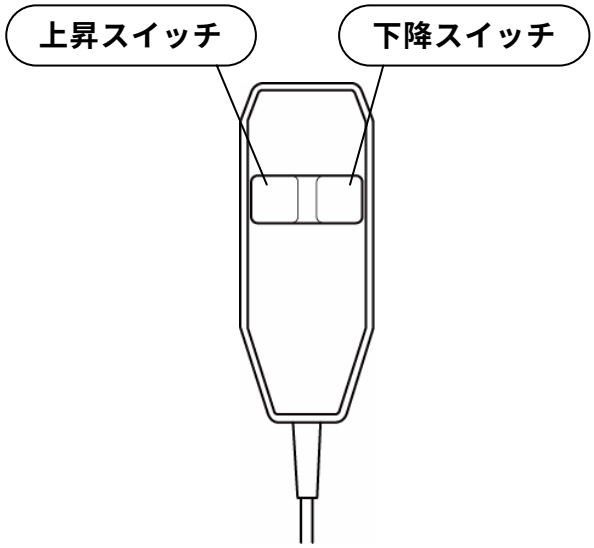

注意
- **使用中には、絶対に昇降操作しない**
  使用者がけがをする恐れがあります。
- **昇降させる前には、周囲を確認**
  周囲や洗面器の下に障害物があると挟み込む恐れがあります。
- **リモコンの上昇と下降スイッチは、同時に押さない**
  誤動作や故障の原因となります。
- **リモコンスイッチは、水につけない**
- **洗面器には、30kg 以上の力を掛けない**
  故障の原因や事故につながる恐れがあります。

シングルレバー混合水栓

レバーハンドルのワンタッチ操作で吐水、止水ができ、温度や吐水量も簡単に調節できます。

注意
- **レバーハンドルはゆっくり動かす**
- **熱湯を吐出させたときの給湯部に注意**
  高温になっていますので、やけどに十分注意してください。
- **湯温に注意**
  止水後、再び吐水する時は、若干温度が変化することがありますのでしばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

お手入れの仕方

- 普段のお手入れは、柔らかい布で空拭きしてください。
- 洗面器は、中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗ってください。
- フレーム部及びトレイは汚れがひどい場合、薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、硬く絞って拭いてください。

⚠ 注意　・クレンザー等の磨き粉を含んだ洗剤やナイロンタワシ等は使用しない
・シンナー，ベンジンなどで拭かない

このようなときには

症　状	原　因	対　策
スイッチを操作しても昇降しない。	プラグがコンセントに入っていない。	コンセントにプラグを差し込んでください。
	電気回路のトラブル	最寄りの営業所にご連絡ください。
昇降中に異音がする。	駆動装置のトラブル	最寄りの営業所にご連絡ください。

- ご使用中に故障が発生したら、すぐに使用を中止してください。
- その他に不明な点がありましたら、最寄りの営業所にご相談ください。

機器の保守・点検について

- 本製品については、機器の管理者の方が以下の点検項目にもとづき、必ず始業点検（日常の製品使用前）を実施してください。
- 長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常に動作するか十分な点検を行ってください。
- **点検時に異常が発見された場合**は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
- 清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします。

始業点検項目

区分	点検内容	点検方法
外観	本体の周囲の障害物の有無	目視
	カバーのガタつき、取付ネジの緩み、脱落	目視 及び、触って確認
	給湯水栓からの水(湯)の漏れ	目視
機能	洗面台の昇降	スムーズに昇降するか、異音がないか確認

保証とアフターサービス

✸ 保証書と保証期間

- 保証書(別添)はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- 保証期間は、正常な使用状態で故障した場合、本体フレームは 5 年間、それ以外は 1 年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

✸ 修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

  機種名　：　*SAD-220*
  お買い上げ年月：　　年　　月
  故障状況(できるだけ詳細に)
  住所，氏名，電話番号

- メーカーより指示のあるとき以外は、決してあけたり分解したりしないでください。

✸ 定期保守点検契約のお勧め

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めします。詳しくは「保守点検契約のお勧め」をご覧になるか、弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

✸ 耐用期間

10 年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

✸ 損耗品（使用により、磨耗･劣化･変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

- 正常な使用において、交換の目安が**約３年**のもの。

  排水ホース / 給湯・給水ホース / 止水栓パッキン

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

✸ 保守部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

仕 様

型　式		ＳＡＤ－２２０
外形寸法		620(W)×650(D)×750(H)㎜
質　量		約４０kg
電　源		単相 100V　50/60 Hz　15A
電　力		30/25W
駆動方式		電動アクチュエーター
材質	本体フレーム	スチール製　塗装仕上げ
	洗面器	陶器
	トレイ部	ステンレス製　塗装仕上げ

注）都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。